
Baustellenlogistik

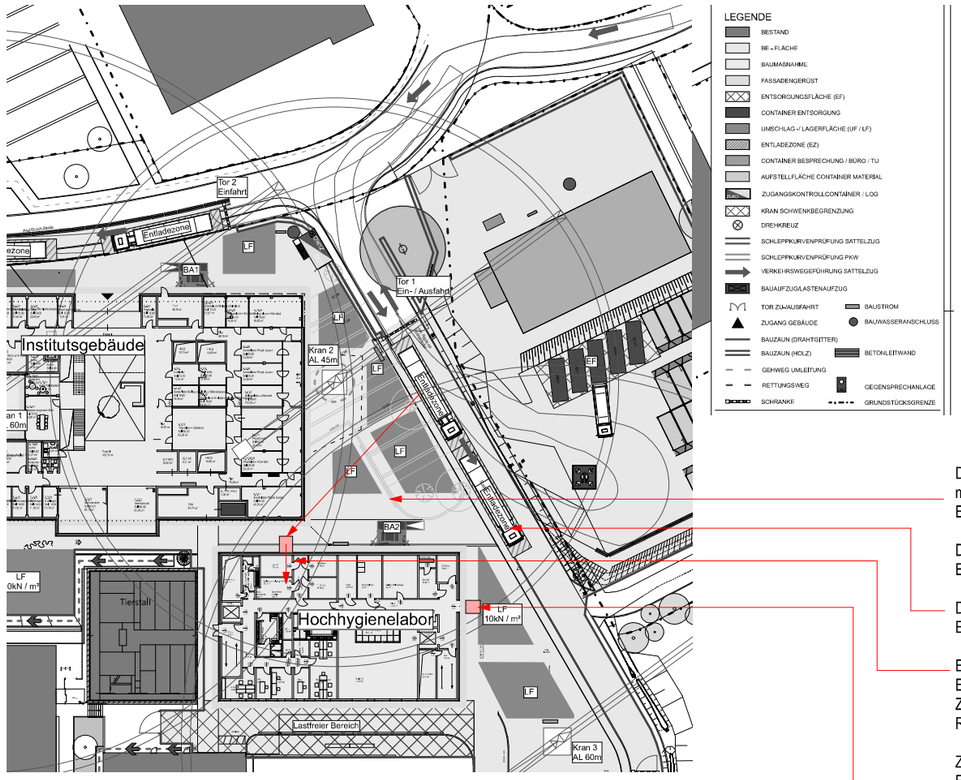

Der Baukran 2 kann von der Entladezone ein Einbringpaket (blau) mit bis zu 6t Gewicht auf Einbringplattform (rot) an die Einbringöffnung (oder den Eingang EG) heben.

Der Bereich zwischen Tierhaus, Institut und Straße ist zum Einbringzeitpunkt nicht befüllt und nicht befahrbar


Die Fahrzeuge, die die Pakete transportieren müssen in der Entladezone entladen werden.

Einbringung erfolgt in das 1. OG, 2. OG und 3. OG über die Einbringöffnungen.
Zeitpunkt Durchfahrautoklaven + H2O2 Kammern: nach Abschluss Rohbau 3.OG (mit Kran 2)


Zeitpunkt Durchreicheautoklaven 1. OG + EG: nach Trocknung Estrich (mit Kran 2 und Kran 3)

Einbringung in das EG erfolgt über den Eingang im Erdgeschoss an der Lastfläche.


1. Obergeschoss

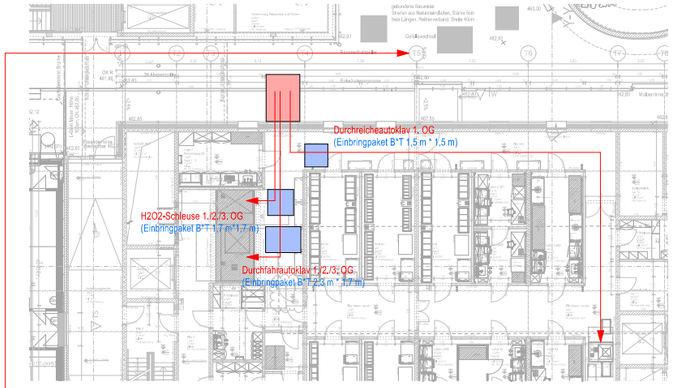

Schnitt Gebäude

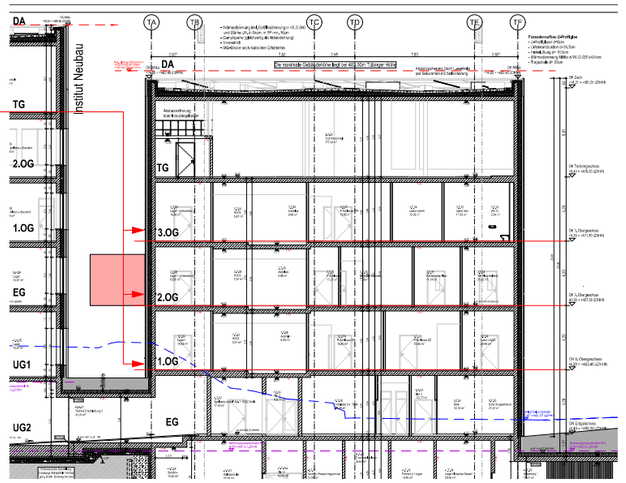

Erdgeschoss

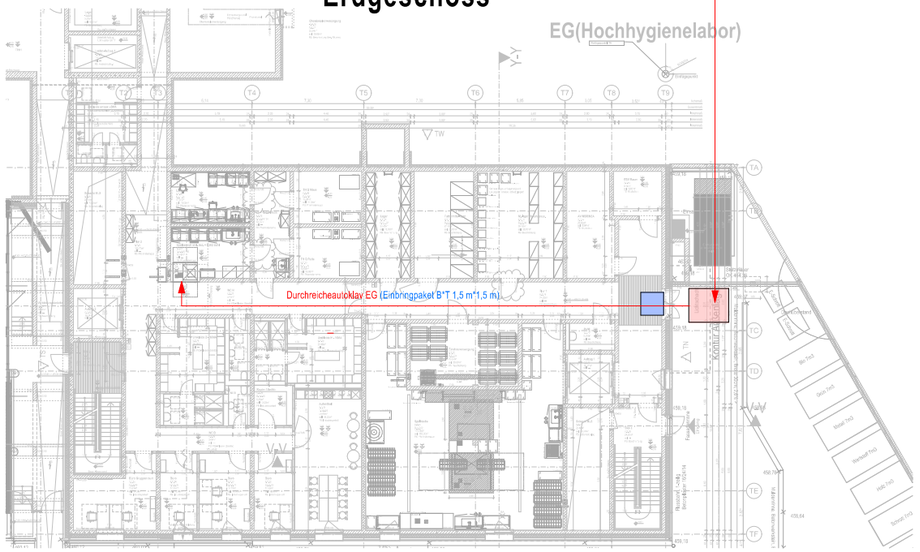

Index	Datum	Name	Änderungen
1	26.08.26	LN	Hinweis alternative Einbringung Durchreicheautoklaven/kammer hinzugefügt.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch in Teilen ohne unsere schriftliche Einwilligung vervielfältigt oder verbreitet, insbesondere nicht an Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden. (§§ 812, 823 BGB, § 2 Abs. 1 Ziffer 7 UrhG) Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Projekt
MPI Biologische Kybernetik Tübingen

Phase
Ausschreibung

Plan-Inhalt
Labortechnik
Schnittstellenbeschreibung Einbringung

Maßstab

	Datum	Name
gezeich.	18.06.26	LN
geprüft	18.06.26	MWi

Zeichnungs-Nr.